


6.5.1 โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยงมีกระบวนการพิจารณายกเลิกการใช้งานเครื่องมือทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การตัดสินใจ ดังนี้

1. เครื่องมือชำรุดเสียหายไม่สามารถซ่อมได้
2. ราคาซ่อมสูงกว่า 25% ของราคาซื้อ หรือราคาซ่อมสะสมสูงกว่า 75% ของราคาซื้อ
3. ราคาค่าเสื่อมสภาพสูงกว่า 60% ของราคาซื้อ
4. ผลการสอบเทียบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและไม่สามารถปรับแก้ได้
5. มีการแจ้งเตือนอันตราย มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยหรือผู้ใช้งาน
6. ไม่มีอะไหล่รับรอง หรือบริษัทผู้ผลิตยกเลิกการสนับสนุน
7. หมดอายุการใช้งานตามอายุการออกแบบ
8. เทคโนโลยีล้าสมัย ไม่รองรับมาตรฐานความปลอดภัยปัจจุบัน

การพิจารณาดำเนินการโดยคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานผู้ใช้งาน และเสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร

การพิจารณายกเลิกการใช้งานเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง

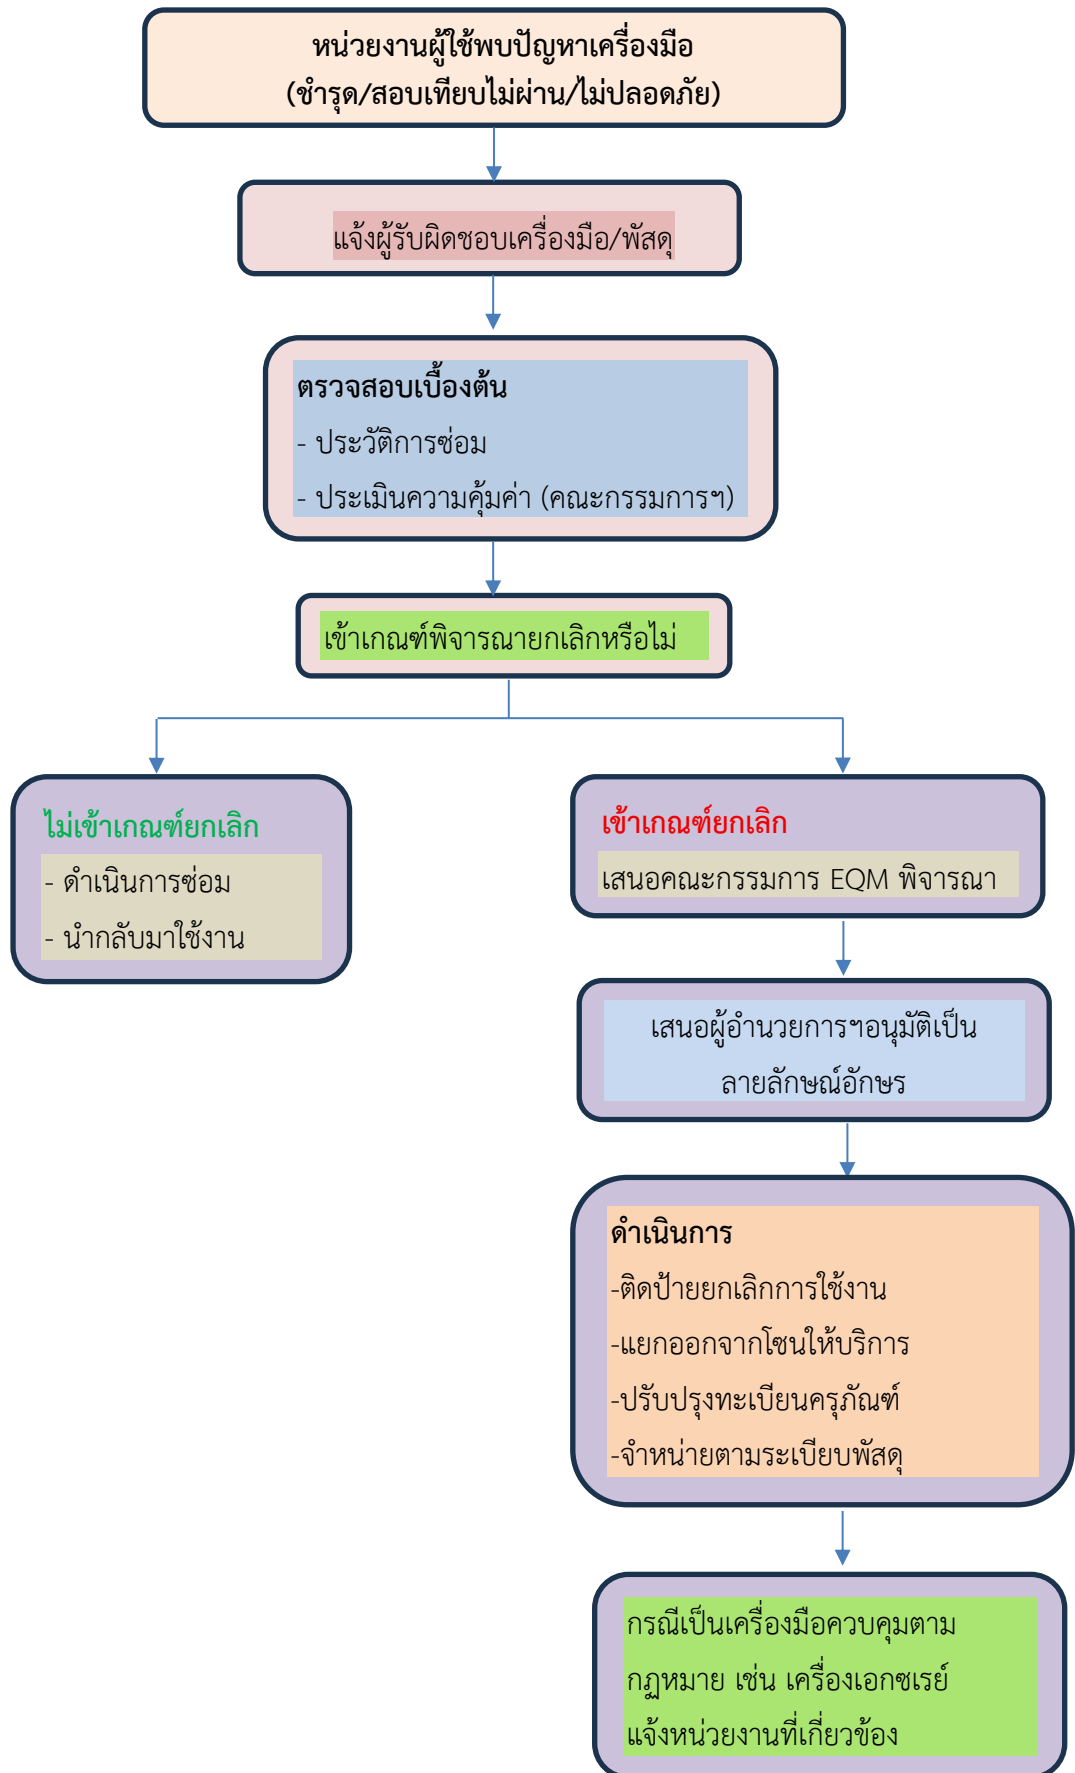

แบบแจ้งครุภัณฑ์ชำรุด

หน่วยงาน ER

วันที่ 9 มี.ค. 2569

เรียน หัวหน้าส่วนพัสดุ

ข้าพเจ้า นางวิมล นิมิตรทอง ตำแหน่ง ผอ. สำนักวิทยบริการ

หน่วยงาน..... ER..... ขอแจ้งครุภัณฑ์ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบเกิดความชำรุดเสียหายไม่สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ มีรายละเอียดดังนี้

[illegible]

จึงเวียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

ตำแหน่ง.....พล.จักษุ.กรรณ.....(หัวหน้าหน่วยงาน)

วันที่ ๑ มี.ค ๖๙

ลงชื่อ.....ผู้นำเสนอ

(47.92157427075 30.64424)

วันที่ 12 ม.ก. 69

ลงชื่อ.....ผู้รับครุภัณฑ์

(૫.૬. ૨૦૧૯)

วันที่ 12 ม.ค. 69

หมายเหตุ ขอให้หน่วยงานนำส่งครุภัณฑ์ที่ชำรุดพร้อมกับแบบแจ้งครุภัณฑ์ชำรุดแนบด้วยทุกครั้ง

Flow Chart การจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง การขายพัสดุครั้งหนึ่ง
ซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันของทรัพย์สิน ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

